

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 155, de 16 de outubro de 1996.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo de termômetro clínico, marca INCOTERM ECOLÓGICO, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização da verificação inicial.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante: INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA.

Endereço: Av. Eduardo Prado, 1670 - Bairro Ipanema - Porto Alegre – RS

CEP: 91751-000

1.2 Descrição: Termômetro de líquido em vidro com escala interna seção reta oval.

1.3 Marca: INCOTERM ECOLÓGICO.

1.4 Utilização: multiuso

1.5 Enchimento: Composto por índio, gálio e zinco.

1.6 Escala nominal: 35°C a 42°C

1.7 Menor divisão: 0,1°C

1.8 Numeração da escala: 1 em 1°C.

1.9 Leitura: deverá ser feita tomando como base a linha central do traço de graduação.

2 FORMA, DIMENSÕES E GRADUAÇÃO:

2.1 Em conformidade com o memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600002377/96.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 As seguintes inscrições devem ser gravadas ou impressas de forma indelével sobre placa porta escala do termômetro.

a) nome do fabricante ou marca;

b) país de origem;

c) °C, e

d) identificação do lote de fabricação e/ou marca de verificação.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificação inicial: Deverá ser feita de acordo com a Portaria nº 234/94 do INMETRO.

4.2 Erro máximo permitido: o erro máximo permitido em qualquer ponto da escala do termômetro é o que corresponde ao prescrito no item 9 da Portaria nº 234/94 do INMETRO.


5 DESENHO ANEXO À PRESENTE PORTARIA:

5.1 Forma, dimensões e graduação da escala do termômetro clínico (Anexo 01).

6 ENTRADA EM VIGOR:

6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz e Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

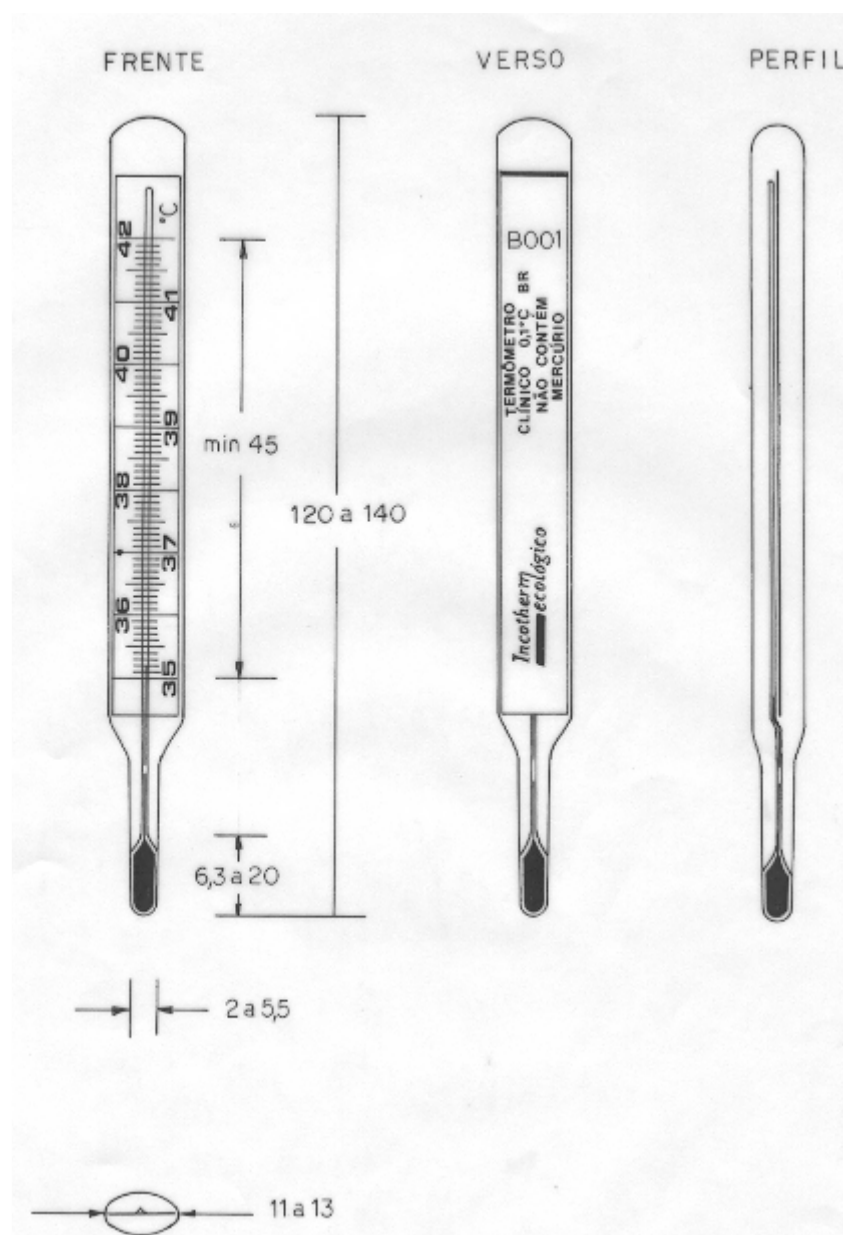

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 155 DE 16 DE outubro DE 1996



FABRICANTE:

INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA.

FORMA, DIMENSÕES E GRADUAÇÃO DA ESCALA DO
TERMÔMETRO CLÍNICO MARCA INCOTERM
ECOLÓGICO

COTAS EM:
mm

ESCALA:
1:1

ANEXO:
01