

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 178, de 29 de outubro de 1996.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, o modelo de termômetro clínico, marca NIPRO, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização da verificação inicial.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante: Nissho Corporation International Division.

Endereço: 3-9-3 Honjo - Nishi, Oyodoku Osaka - Japão

Importador: Morita Importação e Exportação Ltda.

Endereço: Av. Gal. Ataliba Leonel - 1021 - São Paulo - SP CEP. : 02033-000

1.2 Descrição: Termômetro de líquido (Hg) em vidro com escala interna seção reta oval.

1.3 Marca: NIPRO.

1.4 Utilização: multiuso

1.5 Enchimento: mercúrio.

1.6 Escala nominal: 35°C a 42°C

1.7 Menor divisão: 0,1°C

1.8 Numeração da escala: 1 em 1°C.

1.9 Leitura: deverá ser feita tomando como base a linha central do traço de graduação.

2 FORMA, DIMENSÕES E GRADUAÇÃO:

2.1 Em conformidade com o memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600002419/96.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 As seguintes inscrições devem ser gravadas ou impressas de forma indelével sobre placa porta escala do termômetro.

a) nome do fabricante ou marca;

b) país de origem;

c) °C, e

d) identificação do lote de fabricação e/ou marca de verificação

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificação inicial: Deverá ser feita de acordo com a Portaria nº 234/94 do INMETRO.

4.2 Erro máximo permitido: o erro máximo permitido em qualquer ponto da escala do termômetro é que corresponde ao prescrito no item 9 da Portaria nº 234/94 do INMETRO.

5 DESENHO ANEXO À PRESENTE PORTARIA:


5.1 Vistas de composição e corte do termômetro clínico (Anexo 01).

5.2 Forma, dimensões e graduação da escala do termômetro clínico (Anexo 02).

6 ENTRADA EM VIGOR:

6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

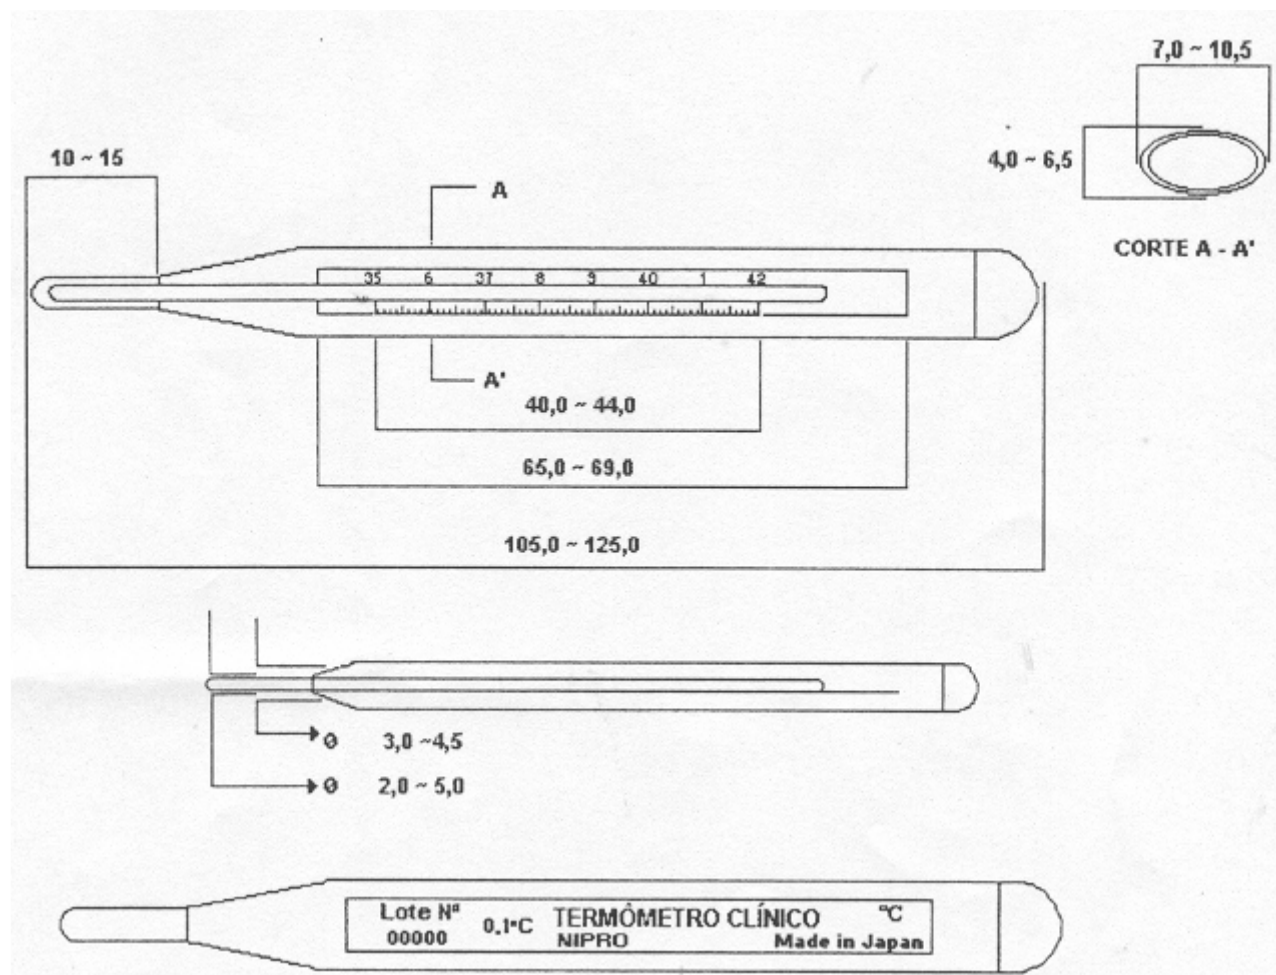

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 178 DE 29 DE outubro DE 1996



FABRICANTE: NISSHO CORPORATION – INTL DIVISION 3-9-3
HONJO-NISHI. OYODOKU-OSAKA-JAPÃO

VISTA DE COMPOSIÇÃO E CORTE DOS TERMÔMETROS
CLÍNICOS DE ESCALA INTERNA; MARCA “NIPRO”, TIPO
OVAL

COTAS EM:
mm

ESCALA:
1:1

ANEXO:
01