

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 358, de 27 de novembro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, os modelos SPECTRUM S-2,5 DA-R; SPECTRUM S-2,5 DAT-R; SPECTRUM S-2,5 X e SPECTRUM S-2,5 FX de medidor eletrônico de energia elétrica, marca NANSEN, conforme as condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

1.1 Nome: Nansen S/A Instrumentos de Precisão

1.2 Endereço: Rua José Pedro de Araújo, 960 - Cinco – Contagem - MG
CEP 32341-560

2 FABRICANTE

2.1 Nome: Nansen S/A Instrumentos de Precisão

2.2 Endereço: Rua José Pedro de Araújo, 960 - Cinco – Contagem - MG
CEP 32341-560

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica ativa e reativa, polifásico.

3.2 Marca: NANSEN

3.3 Modelos: SPECTRUM S-2,5 DA-R; SPECTRUM S-2,5 DAT-R; SPECTRUM S-2,5 X e
SPECTRUM S-2,5 FX

4 CARACTERÍSTICAS DO MODELO

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes características:

4.1 Tensões nominais: 120 e/ou 240 V

4.2 Corrente nominal: 2,5 A

4.3 Corrente máxima: 10 A

4.4 Frequência nominal: 60 Hz

4.5 Número de elementos: 2 e 3

4.6 Número de fios: 3 e 4

4.7 Número de fases: 2 e 3

4.8 Constantes: 1,8 Wh/pulso, 0,3 Wh/pulso e 0,3 varh/pulso

4.9 Formato (tipo de instalação): sobrepor

4.10 Classe de exatidão: C (0,5%)

4.11 Dispositivo indicador: composto de 06 (seis) dígitos em cristal líquido. Modos de exibição conforme memorial descritivo constante do Processo Inmetro n.º 52600.003375/2002

4.12 Dispositivo de calibração: LED

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1 Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esquemáticos e documentação constantes do Processo Inmetro n.º 52600.003375/2002.

6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

A placa de identificação é apresentada em desenho anexo à esta portaria. O medidor deverá portar no mínimo, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições, marcadas de modo indelével:

6.1 Nome ou marca do fabricante;

6.2 Número de série;

6.3 Ano de fabricação;

6.4 Modelo;

6.5 Frequência e tensão;

6.6 Corrente nominal e máxima (esta entre parêntesis);

6.7 Número de fases;

6.8 Número de elementos de medição;

6.9 Número de fios;

6.10 Constantes;

6.11 Índice de classe;

6.12 Esquema de ligações;

6.12.1 O esquema de ligações deverá estar em local de fácil visualização quando da instalação do medidor, caso não conste da placa de identificação.

6.13 Espaço para identificação do usuário e para marca de aprovação de modelo;

7 PLANO DE SELAGEM

7.1 Conforme desenho anexo à esta portaria.

8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA

8.1 ANEXO 01/05 – Vista frontal;

8.2 ANEXO 02/05 – Plano de selagem;

8.3 ANEXO 03/05 – Placa de identificação;

8.4 ANEXO 04/05 – Dimensões externas;

8.5 ANEXO 05/05 – Esquemas de ligação.

9 VALIDADE


9.1 Esta portaria terá validade de 2 (dois) anos, devendo o referido modelo, dentro deste período, ser submetido aos ensaios de compatibilidade eletromagnética definidos no subitem 10.1.10.o. da NIE-DIMEL-036, rev.04

10 ENTRADA EM VIGOR

10.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

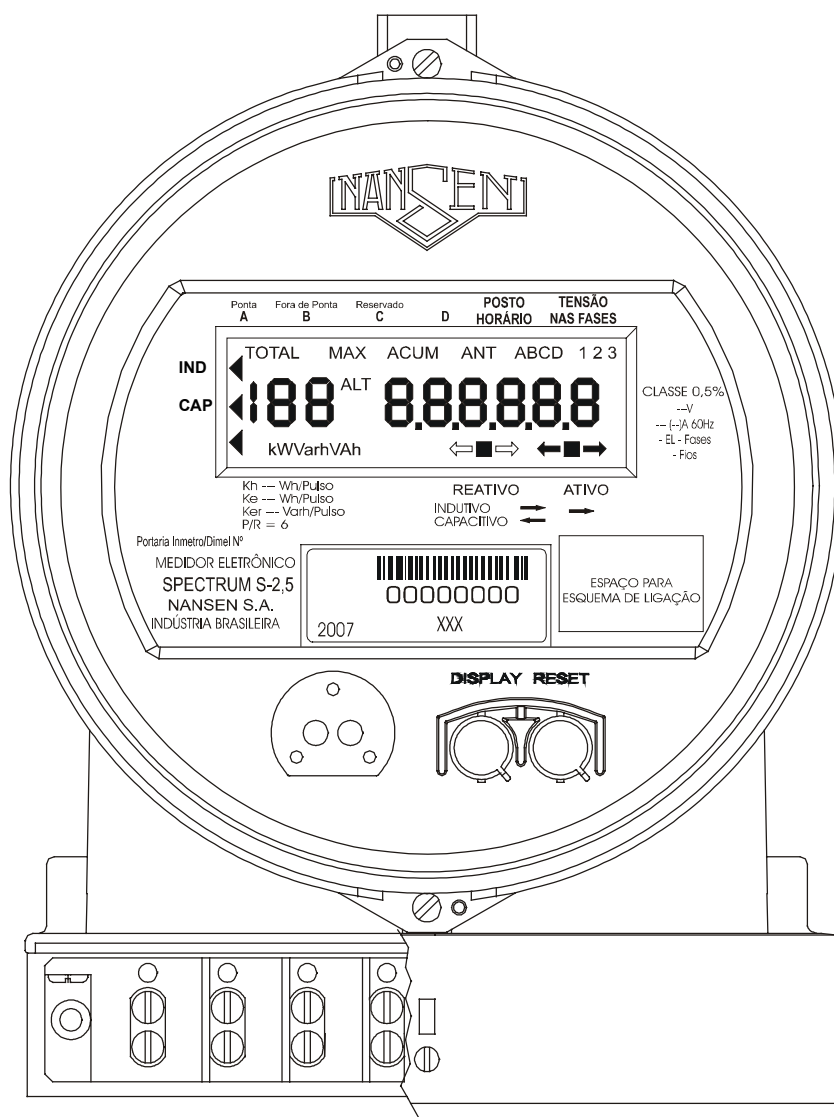

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 358, DE 27 DE novembro DE 2007.



FABRICANTE:

NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.

MODELO SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)

VISTA FRONTAL

COTAS EM:


S/C

ESCALA:

S/E

ANEXO:

01/05

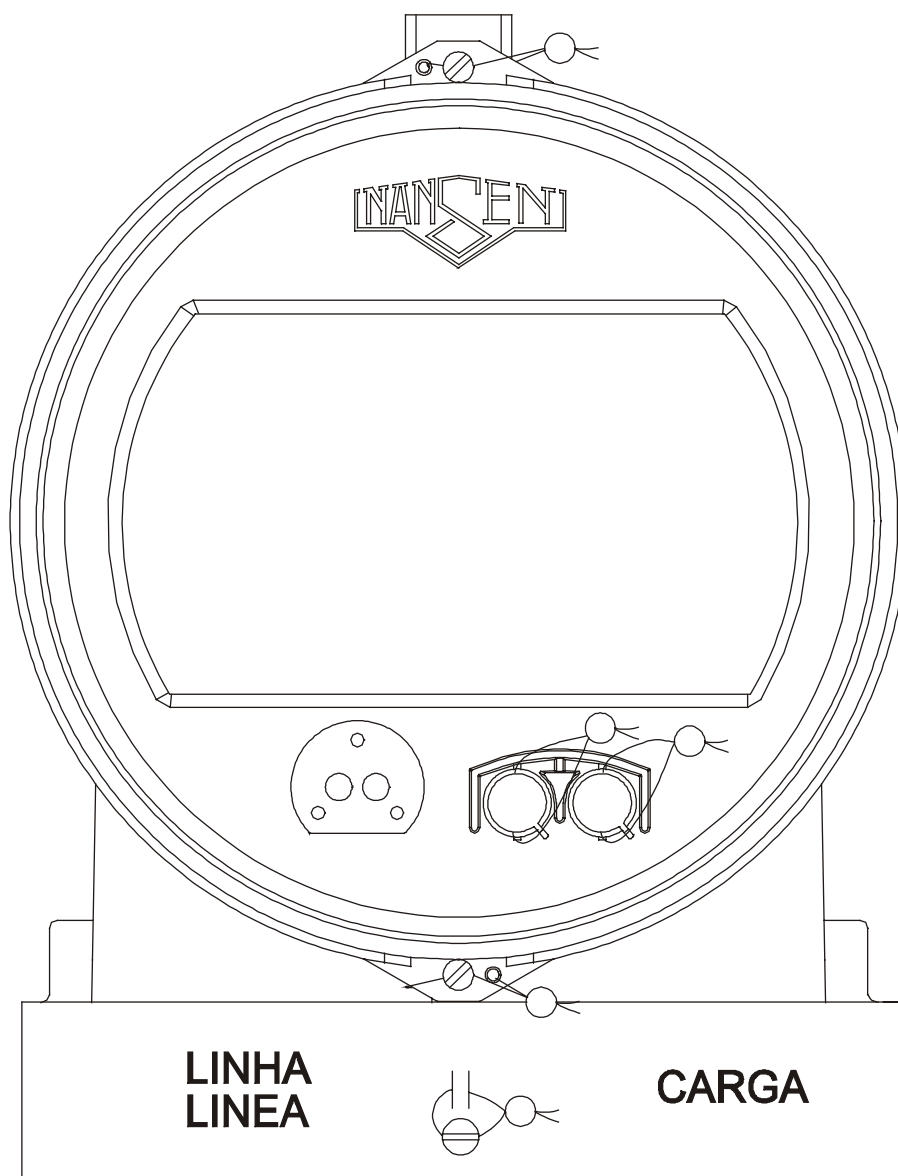

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 358, de 27 de novembro de 2007.



FABRICANTE:

NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.

COTAS EM:

S/C

MODELO SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)


PLANO DE SELAGEM

ESCALA:

S/E

ANEXO:

02/05

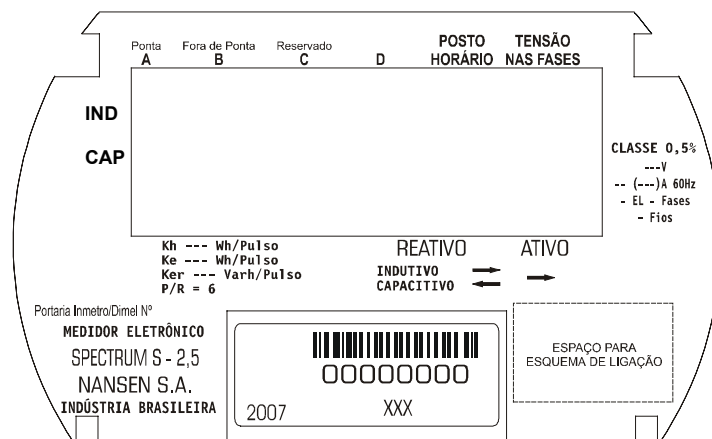


TENSÕES:
120V
240V
120V , 240V

CORRENTE:
2,5(10)A

XXX:
DAR
DAT-R
X
FX

NÚMERO ELEMENTOS	NÚMERO FASES	NÚMERO FIOS
2	2	3
3	3	4

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

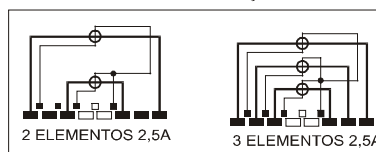

CONSTANTES:	MED. 2,5A
Kh	1,8 Wh/Pulso
Ke	0,3 Wh/Pulso
Ker	0,3 Varh/Pulso

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 358, DE 27 DE novembro DE 2007.



FABRICANTE:

NANSSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.

COTAS EM:

S/C

MODELO SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)


PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ESCALA:

S/E


ANEXO:

03/05

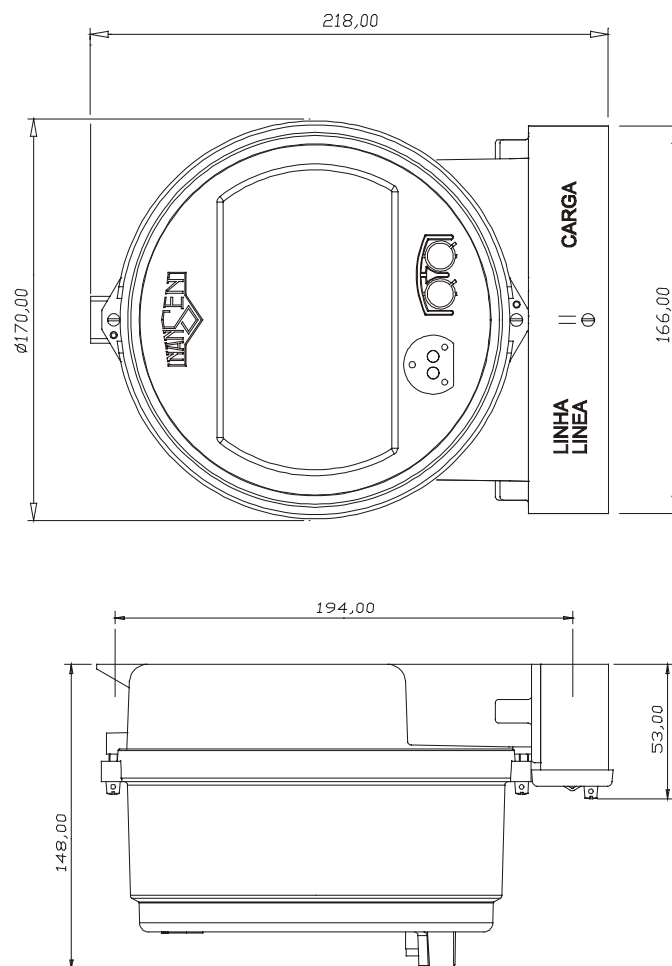


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 358, DE 27 DE novembro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.	mm
	MODELO SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)	ESCALA:
	DIMENSÕES EXTERNAS	S/E
		ANEXO:
		04/05

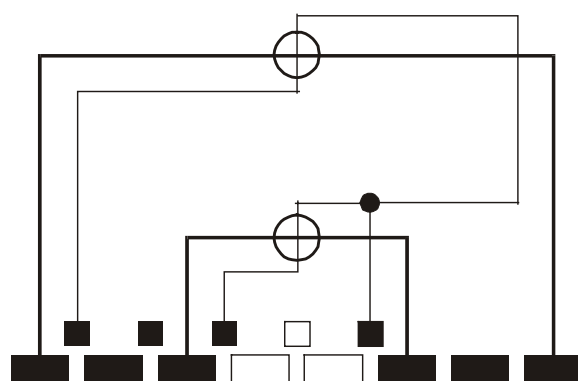

2 ELEMENTOS 2,5A

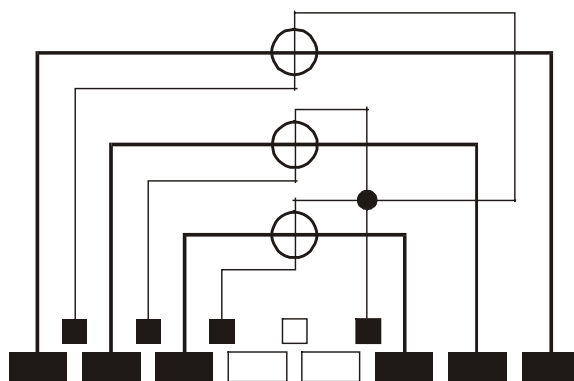

3 ELEMENTOS 2,5A

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 358, DE 27 DE novembro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.	S/C
	MODELO SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX) ESQUEMAS DE LIGAÇÃO	ESCALA: S/E
		ANEXO: 05/05