

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 203, de 11 de julho de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, e;

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.074818/2007, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 348, de 13 de novembro de 2007, que aprova o modelo SPECTRUM K-2,5 ART, de medidor eletrônico de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão B (1%), marca NANSEN, resolve:

Art. 1º - Incluir no item 8 da referida portaria, os desenhos de acordo com os anexos à presente portaria:

8) (...)

“8.1.A ANEXO 01A – Vista frontal sem porta óptica e botão de reset;


8.2.A ANEXO 02A – Placa de identificação sem porta óptica e botão de reset.” (NR)

Art. 2º - As alterações no modelo SPECTRUM K-2,5 ART a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 348, de 13 de novembro de 2007.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

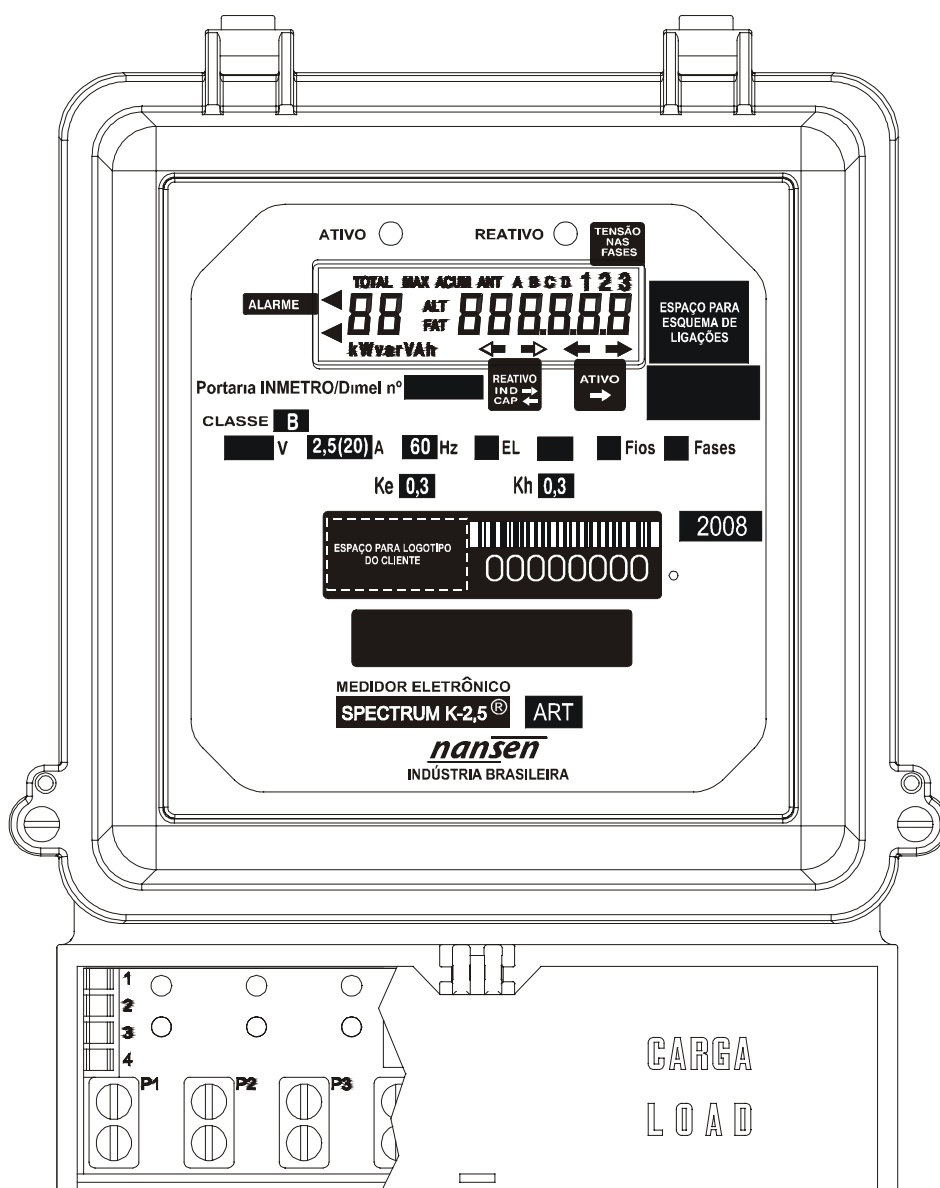

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 203, DE 11 DE julho DE 2008.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.

Modelo SPECTRUM K-2,5 ART

VISTA FRONTAL
SEM PORTA ÓPTICA E BOTÃO DE RESET

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01A

ATIVO ☐ REATIVO ☐ TENSÃO NAS FASES

ALARME ☐

ESPAÇO PARA ESQUEMA DE LIGAÇÕES

Portaria INMETRO/Dimel nº

CLASSE **B**

REATIVO IND CAP ☐ ATIVO ☐

V 2,5(20) A 60 Hz ☐ EL ☐ Fios ☐ Fases

Ke 0,3 Kh 0,3

ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO CLIENTE

00000000

2008


MEDIDOR ELETRÔNICO
 SPECTRUM K-2,5® ART

nansen
 INDUSTRIA BRASILEIRA

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS:

3EL	(Y)	4Fios	3Fases
2EL	(Y)	3Fios	3Fases
2EL	(Y)	3Fios	2Fases
2EL	(Δ)	3Fios	2Fases
2EL	(Δ)	3Fios	3Fases

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

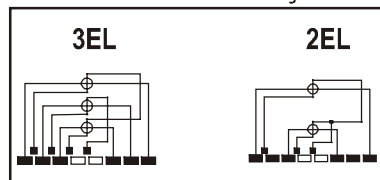

TENSÕES POSSÍVEIS:

120V
 240V
 120 , 240V

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 203, DE 11 DE julho DE 2008.



FABRICANTE:
 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.

Modelo SPECTRUM K-2,5 ART
 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
 SEM PORTA ÓPTICA E BOTÃO DE RESET

COTAS EM:
 S/C

ESCALA:
 S/E

ANEXO:
 02A