

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 189, de 30 de junho de 2008 .

(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 089, de 07 de junho de 2006)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para hidrômetros aprovado pela Portaria Inmetro nº 246, de 17 de outubro de 2000.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro nº 52600.019477/2008, com vista a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 089, de 07 de junho de 2006, que aprova o modelo UNIMAG TU III HV de hidrômetro, marca Actaris, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 1.4.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 089/2006, que passará a ter a seguinte redação:

“1.4.1 Fabricado com relojoaria em plástico, plana ou inclinada; proteção em vidro com anel metálico e pré equipado para captura de pulsos.” (NR)

Art. 2º - Substituir os desenhos constantes dos subítem 5.1 e 5.4 da Portaria Inmetro/Dimel nº 089/2006, pelos desenhos anexos a esta Portaria:

“Desenhos anexos:


5.1 Anexo 1A – Vista do mostrador, com inscrições, para o hidrômetro de Qn 1,5m³/h

5.4 Anexo 4A – Vista do mostrador, com inscrições, para o hidrômetro de Qn 2,5m³/h.” (NR)


Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RECHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro


Tipos de relojoaria: As inscrições obrigatórias constantes do totalizador podem ser dispostas de forma diferente.

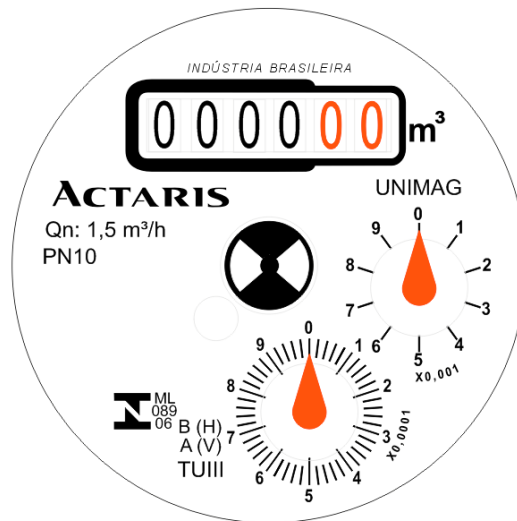

Mostrador para relojoaria plana

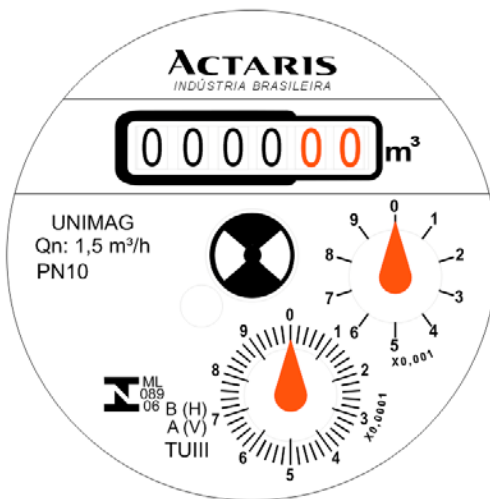

Mostrador para relojoaria inclinada

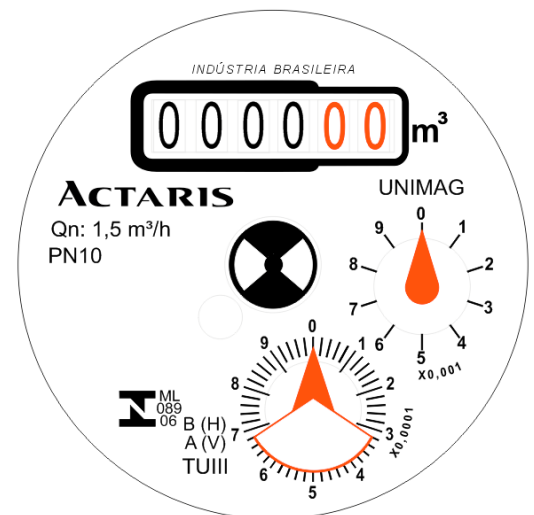

Mostrador para relojoaria pré-equipada


Opcionais:

- Fechamento standard click, soldada ou copper can (Cobre/vidro)
- Giro total ou parcial
- Cinta metálica
- Dispositivo que indica força excessiva sobre a relojoaria
- Logotipo do cliente
- Código de barras


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 189 DE 30 DE JUNHO DE 2008.

	FABRICANTE:	ACTARIS LTDA	COTAS EM: mm
	VISTA DO MOSTRADOR, COM INSCRIÇÕES, PARA O HIDRÔMETRO DE Qn 1,5m ³ /h		ESCALA: SEM ESCALA
	MEDIDOR UNIMAG TU III HV		ANEXO: 1A


Tipos de relojoaria: As inscrições obrigatórias constantes do totalizador podem ser dispostas de forma diferente.

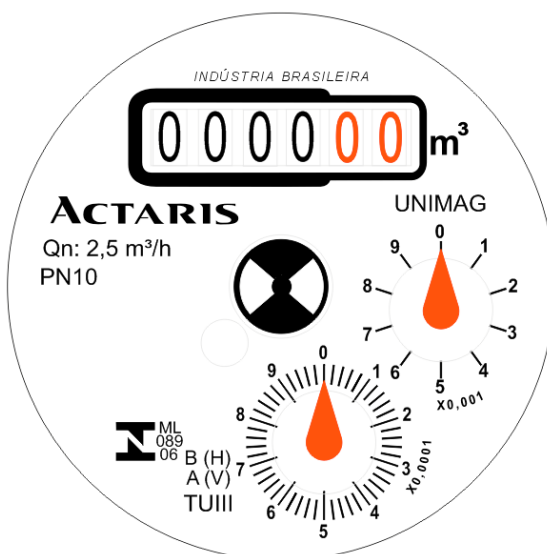

Mostrador para relojoaria plana

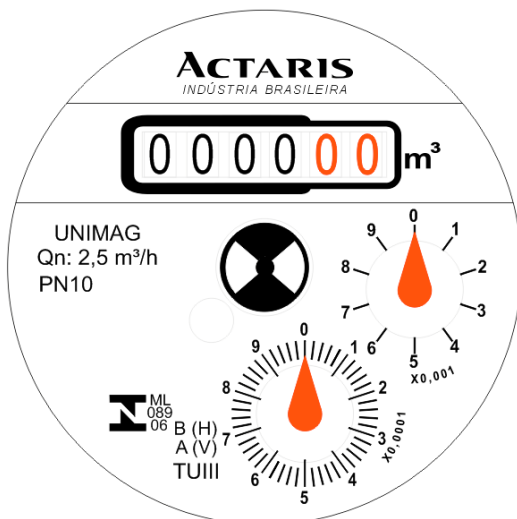

Mostrador para relojoaria inclinada

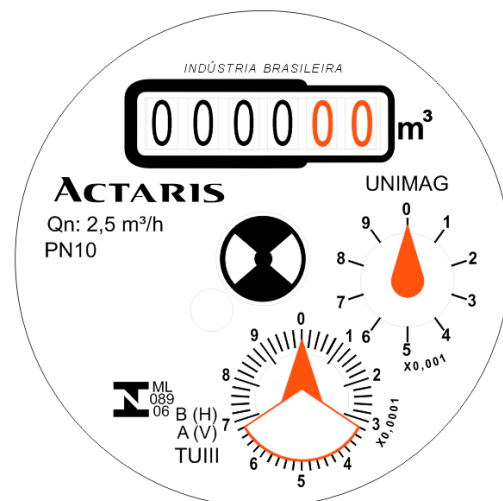

Mostrador para relojoaria pré-equipada

Opcionais:

- Fechamento standard click, soldada ou copper can (Cobre/vidro)
- Giro total ou parcial
- Cinta metálica
- Dispositivo que indica força excessiva sobre a relojoaria
- Logotipo do cliente
- Código de barras

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 189, DE 30 DE JUNHO DE 2008.

	FABRICANTE:	ACTARIS LTDA	COTAS EM: mm
	VISTA DO MOSTRADOR, COM INSCRIÇÕES, PARA O HIDRÔMETRO DE $Q_n 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$		ESCALA: SEM ESCALA
	MEDIDOR UNIMAG TU III HV		ANEXO: 4A