



Portaria Inmetro/Dimel nº 153, de 22 de abril de 2009.
(2º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 193/2005)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600.037653/2008, apresentados por TDS Instrumental Ltda.;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 193, de 10 de novembro de 2005, que aprova, em caráter provisório, o modelo BS3000A, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, marca BIOMETTRIX;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 005 de 14 de janeiro de 2008, que prorroga até 10 de novembro de 2009 o prazo de validade da Portaria Inmetro/Dimel nº 193/2005; e,

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Incluir, em caráter opcional, as marcas CELTAC ou BIOPRECISA no modelo BS3000A, a que se refere a Portaria Inmetro/Dimel nº 193/2005.

Art. 2º - Incluir os desenhos anexos à presente portaria:

- 1-Vista da placa de identificação do modelo BS3000A com a marca CELTAC.
- 2-Vista da placa de identificação do modelo BS3000A com a marca BIOPRECISA.

Art. 3º - A presente inclusão está condicionada a manutenção das demais exigências constates da referida portaria de aprovação de modelo e portaria a ela vinculada.


Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Dimas
RS/rs
BIOMETTRIX_037653_08



TDS Instrumental Tecnológica Ltda.
 Rod. Pr 281, SNº KM 09 - Tijucas do Sul - PR - Brasil. CEP: 83190-000 Tel.: (41) 3332-1447
 Marca: Celtac
 Modelo: BS3000A
 Classe de Exatidão: II
 Max: 3000g Min: 5g e = 0,1 g
 5°C / 40°C
 Numero de Série: Ano:
 Portaria Inmetro/Dimel nº:
 Interditado Para Venda Direta ao Publico / Transações Comerciais

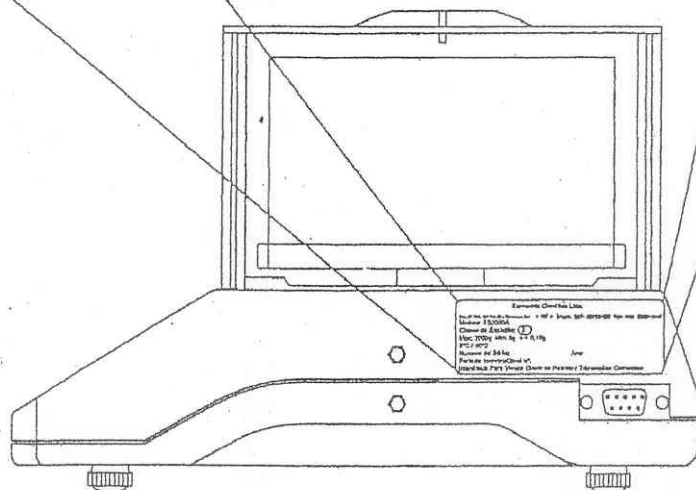

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL nº 153 DE 22 DE ABRIL DE 2009.



FABRICANTE: TDS Instrumental tecnológica Ltda.


COTAS EM:

Vista da placa de identificação do modelo BS3000A com a marca
 CELTAC.

ESCALA:

ANEXO:01

TDS Instrumental Tecnológica Ltda.
 Rod. Pr 281, SNº KM 09 - Tijucas do Sul - PR - Brasil, CEP: 83190-000 Tel: (41) 3332-1447
 Marca: BIOPRECISA
 Modelo: BS3000A
 Classe de Exatidão: II
 Max: 3000g Min: 5g $e = 0,1 \text{ g}$
 5°C / 40°C
 Numero de Série: Ano:
 Portaria Inmetro/Dímel nº:
 Interditado Para Venda Direta ao Publico / Transações Comerciais

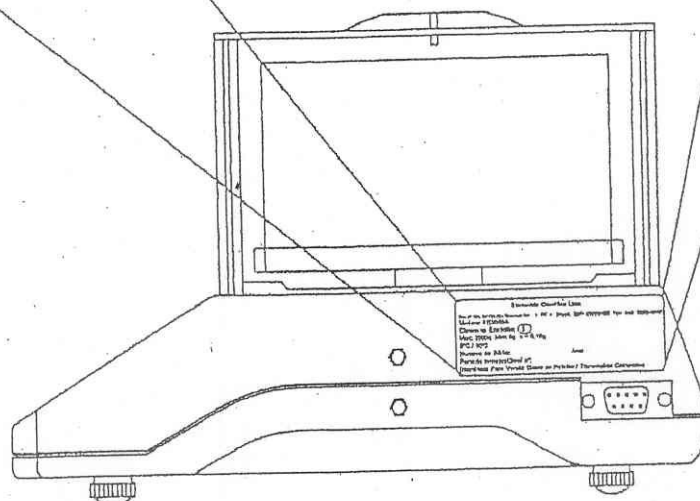

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL nº 153 DE 22 DE ABRIL DE 2009.



FABRICANTE: TDS Instrumental tecnológica Ltda.

COTAS EM:

Vista da placa de identificação do modelo BS3000A com a marca BIOPRECISA.

ESCALA:

ANEXO:02