



Portaria Inmetro/Dimel nº 186, de 02 de junho de 2009.
(3º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 160/2005)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600.037648/2008, apresentados por TDS Instrumental Tecnológica Ltda.;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 160, de 29 de setembro de 2005, que aprova em caráter provisório, o modelo FA2104N, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, marca BIOMETTRIX e, os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 191, de 18 de setembro de 2006, que modifica a razão social do fabricante do modelo FA2104N;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 004 de 14 de janeiro de 2008, que prorroga até 29 de setembro de 2009 o prazo de validade da Portaria Inmetro/Dimel nº 160/2005; e,

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Incluir, em caráter opcional, nova máscara (layout) com as marcas CELTAC ou BIOPRECISA no modelo FA2104N, a que se refere a Portaria Inmetro/Dimel nº 160/2005.

Art. 2º - Incluir os desenhos anexos à presente portaria:

1-Vista da nova máscara (layout) do modelo FA2104N com a marca CELTAC.


2-Vista da nova máscara (layout) do modelo FA2104N com a marca BIOPRECISA.

Art. 3º - A presente inclusão está condicionada a manutenção das demais exigências constantes da referida portaria de aprovação de modelo e portaria a ela vinculada.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



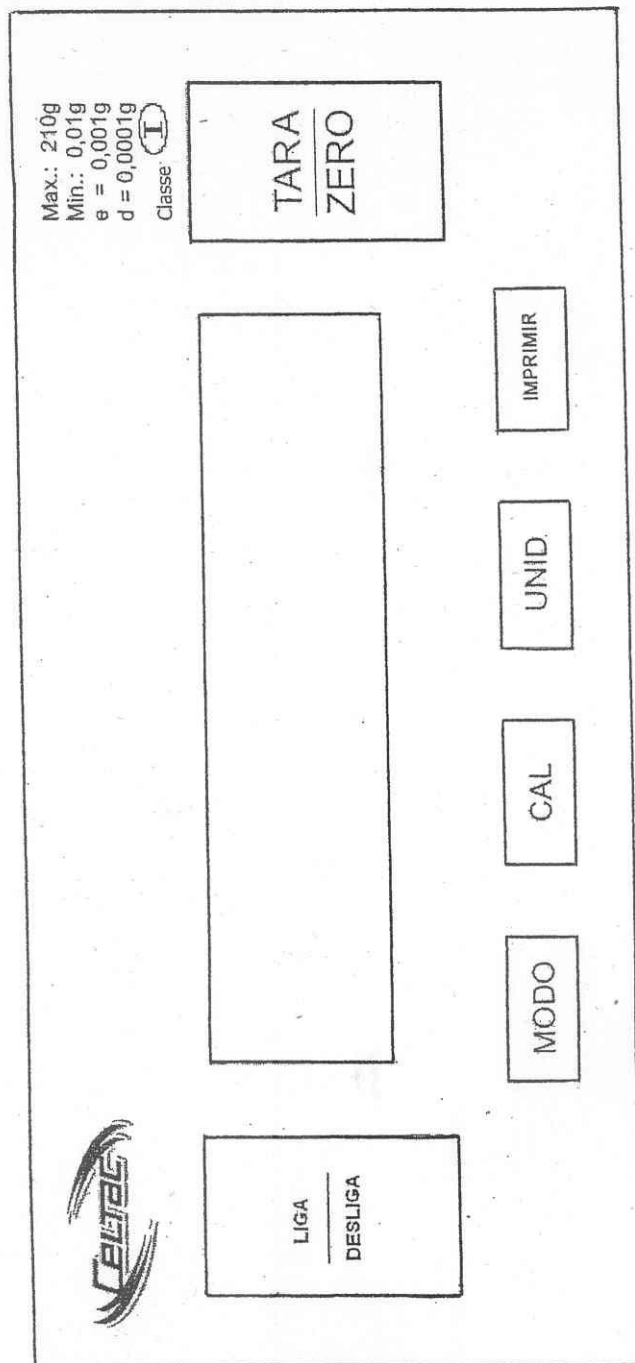

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 186 DE 02 DE JUNHO DE 2009.




FABRICANTE: TDS Instrumental Tecnologia Ltda.

Vista da nova máscara (layout) do modelo FA2104N com a marca CELTAC.

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:01

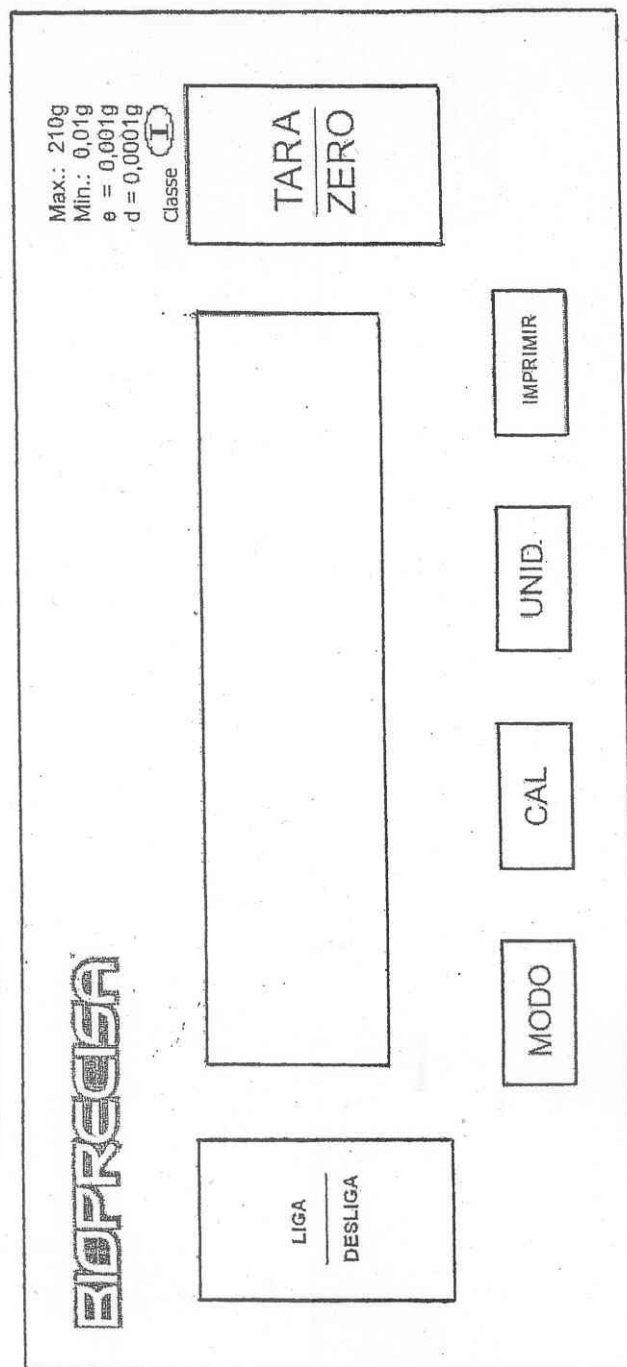

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 186 DE 02 DE JUNHO DE 2009.



FABRICANTE: TDS Instrumental Tecnologia Ltda.

COTAS EM:

Vista da nova máscara (layout) do modelo FA2104N com a marca BIOPRECISA.

ESCALA:

ANEXO:02