



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0101, de 18 de maio de 2010.
(2º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 310/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.053481/2009, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, que aprova o modelo NP55 120A, de medidor eletrônico de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão B, marca SmartIMS, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 da Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, que passam a ter a seguinte redação:

...

“1.1 Nome: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA.

1.2 Endereço: Rua Santo Bassan, n.º 1.345, Bosque das Palmeiras – Campinas – SP
CEP 13 086-745.

2.1 Nome: ADD GROUP

2.2 Endereço: M. Costin str. 5, Kishinev – MD-208 – Moldávia ” (NR)

...

Art.2º - Dar nova redação ao subitem 3.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

...

“3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica, ativa e reativa, polifásico, unidirecional.” (NR)

...

Art. 3º - Alterar os subitens 4.5, 4.6 e 4.7 da Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, que passam a ter a seguinte redação:



...

“4.5 Número de elementos: 2 e 3

4.6 Número de fios: 3 e 4

4.7 Número de fases: 2 e 3” (NR)

...

Art. 4º - Incluir o subitem 4.13 na Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, com a seguinte redação:

...

“4.13 Configurações: 2 elementos / 3 fios / 2 fases (Estrela)

3 elementos / 4 fios / 3 fases (Estrela)”

...

Art. 5º - Substituir os anexos, do item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 310, de 13 de novembro de 2007, pelos desenhos anexos a esta Portaria:

...

“ - ANEXO 01/05 – Vista frontal;

- ANEXO 02/05 – Placas de identificação;

- ANEXO 03/05 – Plano de selagem;

- ANEXO 04/05 – Esquemas de ligação;

- ANEXO 05/05 – Dimensões externas.” (NR)


...

Art. 6º - As alterações no modelo NP55 120A a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel nºs 310, de 13 de novembro de 2007 e 182, de 28 de maio de 2009.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Espaço reservado p/ o número de série do cliente (10x50mm)



Espaço reservado p/ o número do medidor

Àrea reservada p/ Portaria INMETRO/ DIMEL

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0101, DE 18 DE MAIO DE 2010.



FABRICANTE:

ADD GROUP

COTAS EM:
S/C


Modelo NP55 120A

ESCALA:
S/E

VISTA FRONTAL


ANEXO:
01/05

EM 120 V

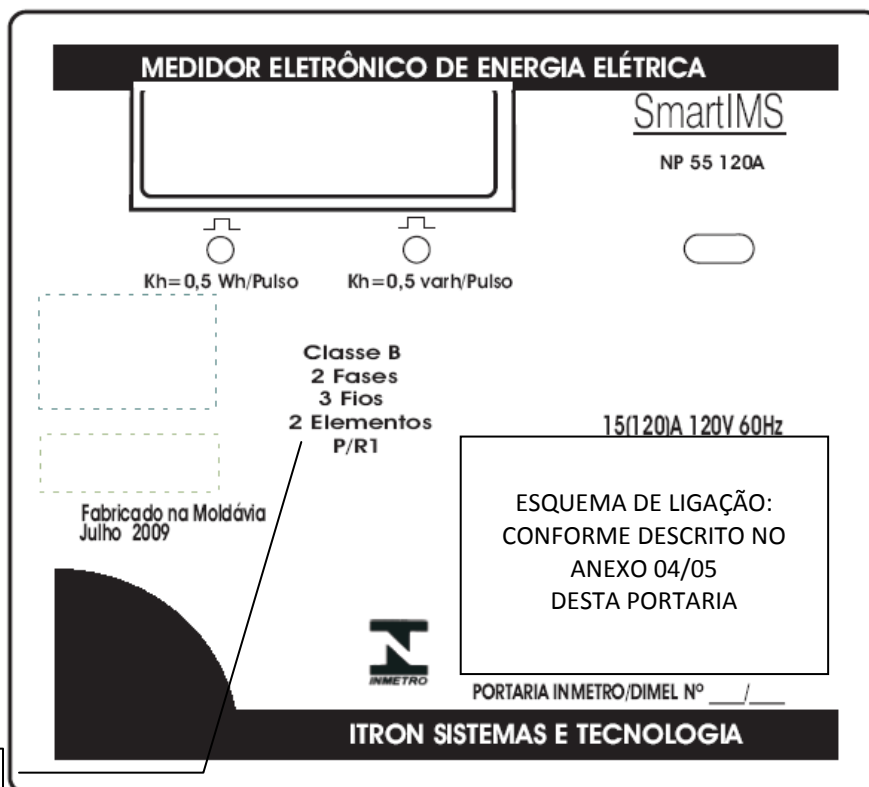


CONFIGURAÇÕES
POSSÍVEIS DE
FASES/ELEMENTOS/
FIOS CONFORME
DESCRITO NO
SUBITEM 4.13

EM 220 V

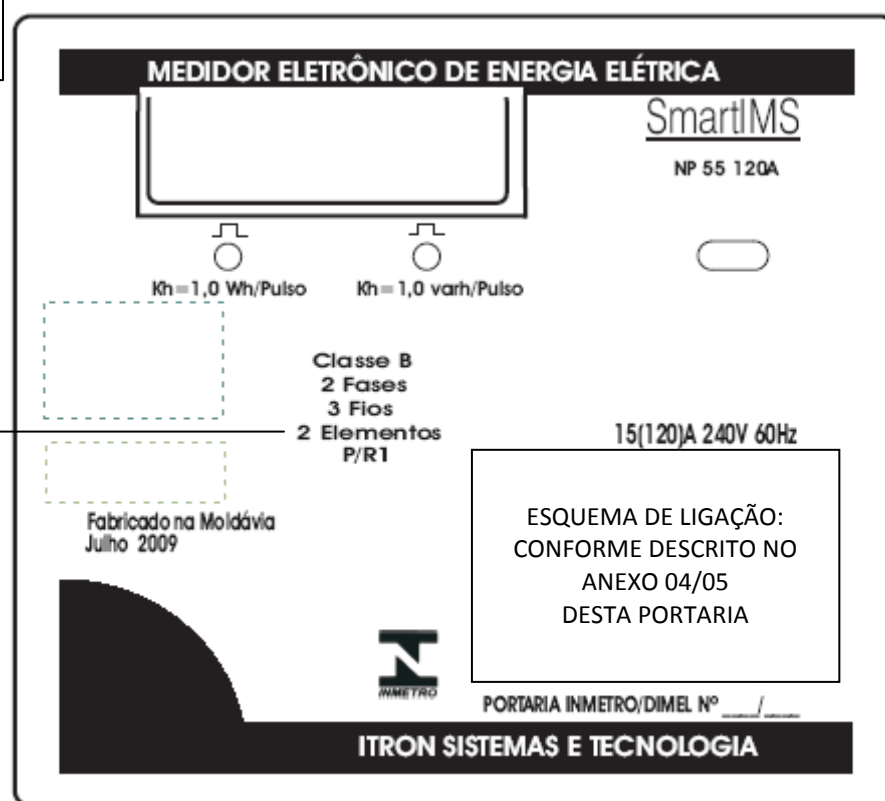

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0101, DE 18 DE MAIO DE 2010.

	FABRICANTE:	ADD GROUP	COTAS EM: S/C
		Modelo NP55 120A	ESCALA: S/E
		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	ANEXO: 02/05

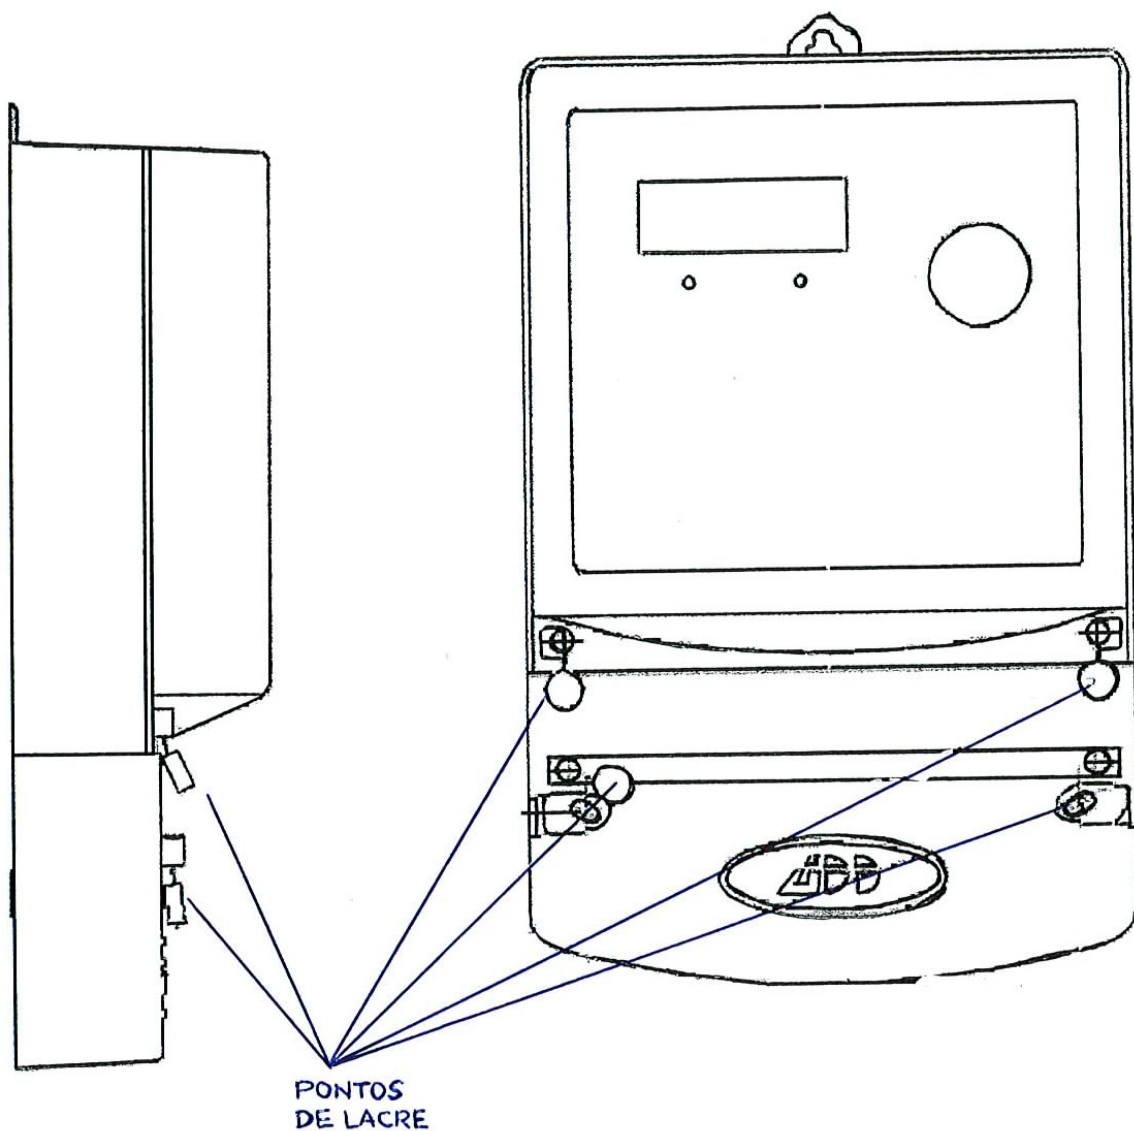

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0101, DE 18 DE MAIO DE 2010.



FABRICANTE:

ADD GROUP


Modelo NP55 120A
PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/05

2 ELEMENTOS

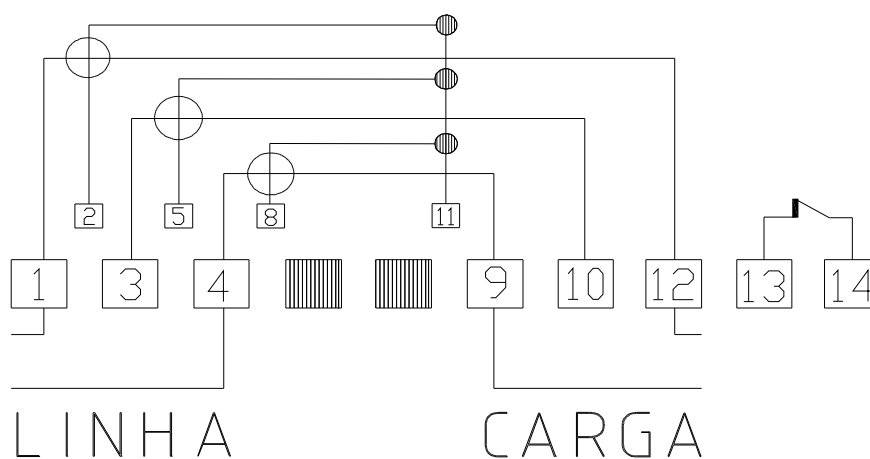

3 ELEMENTOS

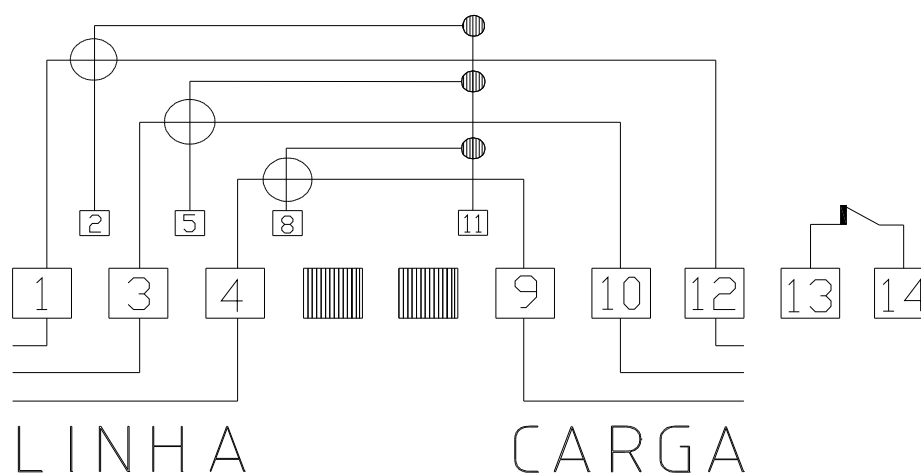

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0101, DE 18 DE MAIO DE 2010.



FABRICANTE:

ADD GROUP


Modelo NP55 120A

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05

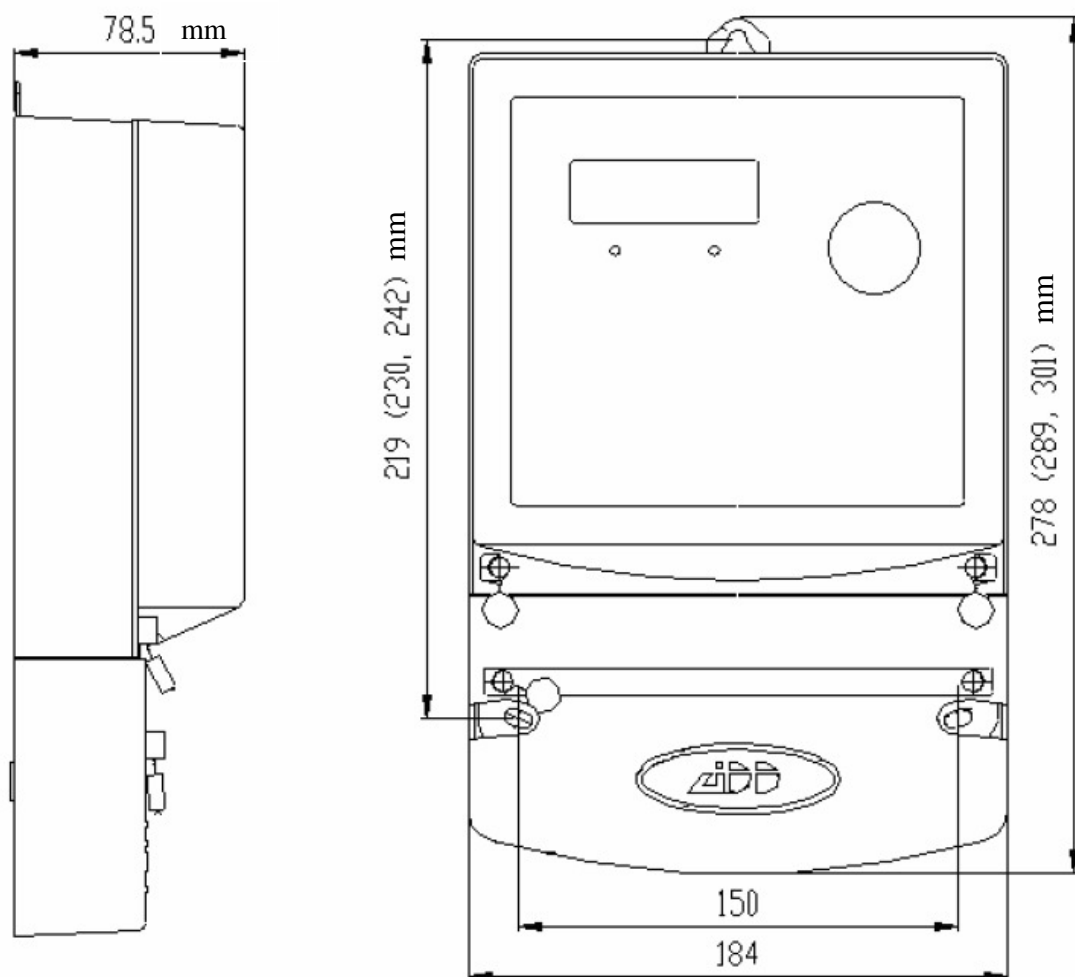

LEGENDA:

A DIMENSÃO “A” PODE VARIAR CONFORME A POSIÇÃO DO GANCHO: “A” PODE SER: (278, 289 ou 301) mm.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0101, DE 18 DE MAIO DE 2010.



FABRICANTE:

ADD GROUP

COTAS EM:
mm

Modelo NP55 120A

ESCALA:
S/E

DIMENSÕES EXTERNAS

ANEXO:
05/05