



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0290, de 05 de outubro de 2011.
(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 143/2010)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.024680/2011, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 0143, de 16 de junho de 2010, que aprova os modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2, de medidor de energia elétrica, monofásico, classe de exatidão B, marca COMPLANT, resolve:

Art.1º - Autorizar, em caráter opcional, a utilização de nova caixa plástica com novas dimensões, nova localização dos terminais de saída de pulsos e incorporação de suporte plástico na base.

Art. 2º - Substituir no subitem 10.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 0143, de 16 de junho de 2010, os desenhos pelos anexos a esta portaria:

...

“ - ANEXO 01/08 – Vista frontal;
- ANEXO 02/08 – Placas de identificação;
- ANEXO 03/08 – Plano de selagem;
- ANEXO 04/08 – Esquemas de ligação;
- ANEXO 05/08 – Terminais de ligação;
- ANEXO 06/08 – Pontos de fixação;
- ANEXO 07/08 – Tampa do bloco de terminais;
- ANEXO 08/08 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 3º - As alterações nos modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2, a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 0143, de 16 de junho de 2010.



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - **INMETRO**

Continuação da Portaria Inmetro/Dimel n.º 0290, de 05 de outubro de 2011.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.


LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Divel
Saportugal / Lcsantiliano
CAM_024680_11



Diretoria de Metrologia Legal - Dimel
Divisão de Instrumentos de Medição no Âmbito da Eletroeletrônica - Divel
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças nº 50- Xerém - Duque de Caxias- RJ - CEP: 25250-020
Telefones: (0xx21) 2679-9181/9808 Fax: (0xx21) 2679-9181 - e-mail: divel@inmetro.gov.br

Página 02 / 02

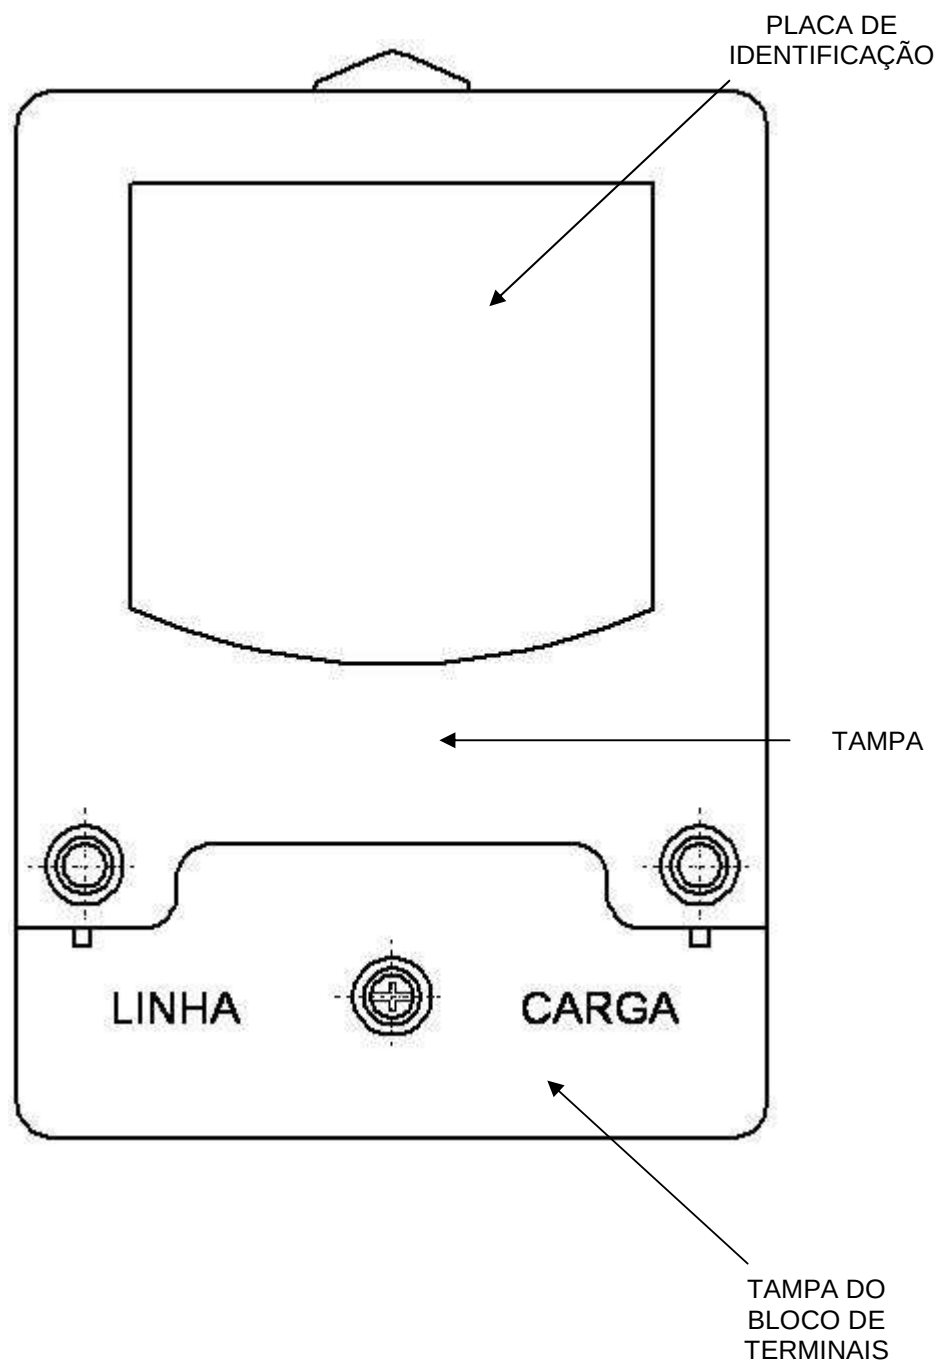

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).

COTAS EM:
S/C


Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

ESCALA:
S/E


VISTA FRONTAL

ANEXO:
01/08

MODELO MEP01-PLC1

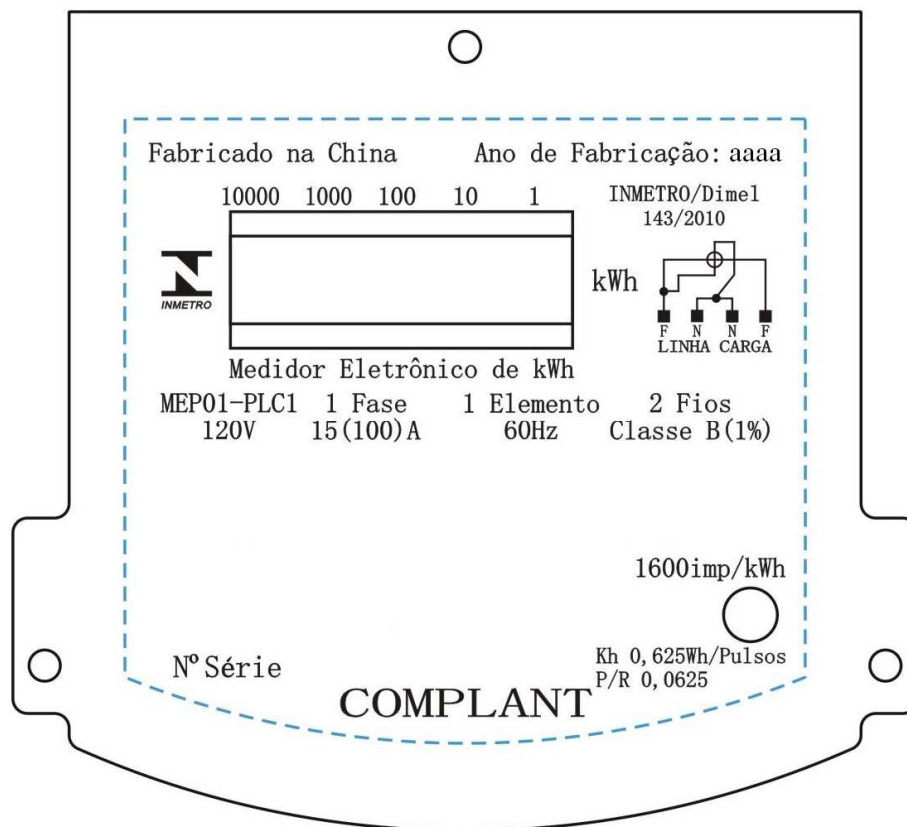

MODELO MEP01-PLC2

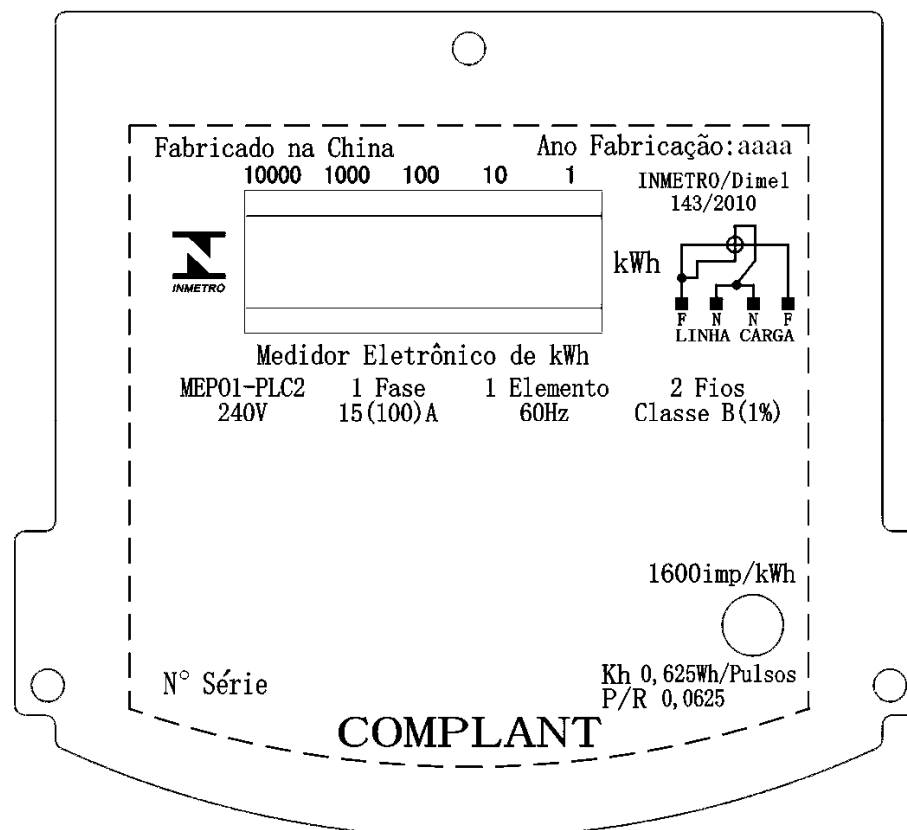

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).


COTAS EM:
S/C

Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/08

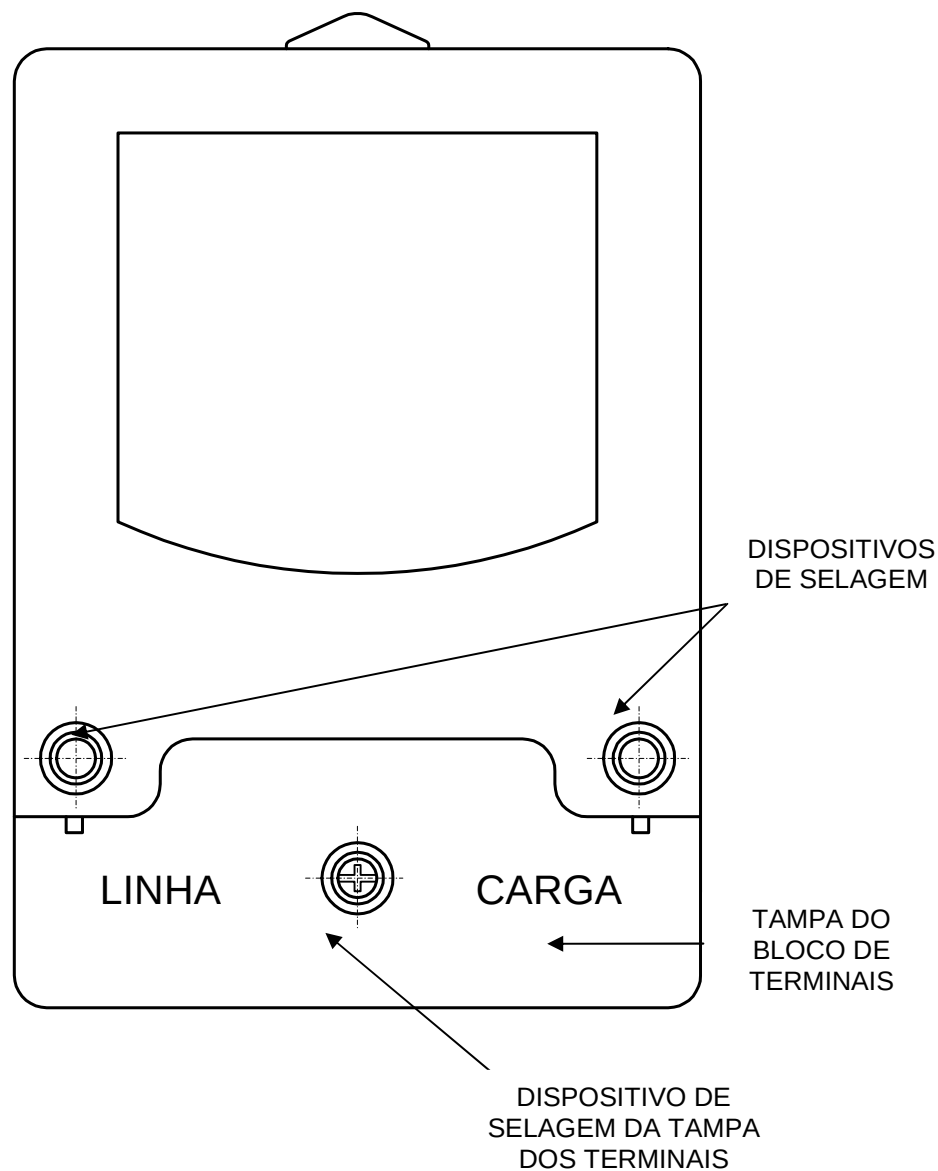

Medidor com fechamento por lacre ou por lacre e aplicação de ultrassom.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:
China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).

Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2


PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E


ANEXO:
03/08

SEM SAÍDA DE PULSO

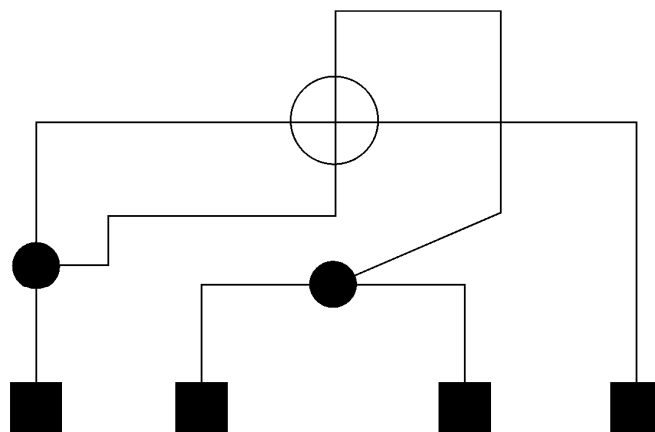

LINHA CARGA

COM SAÍDA DE PULSO

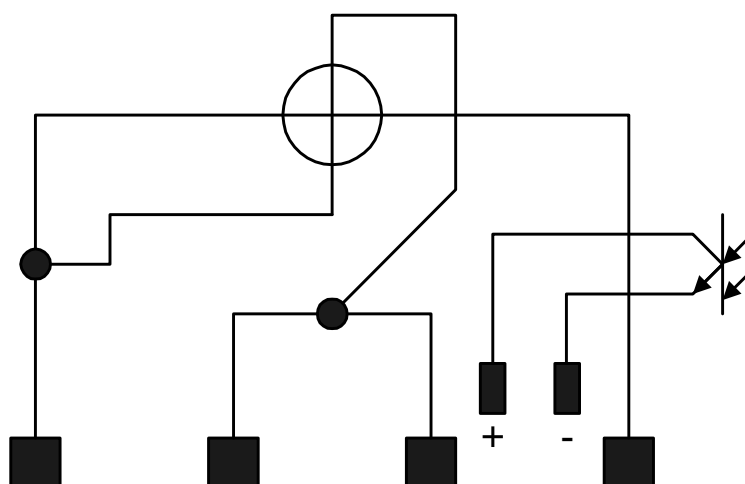

LINHA CARGA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:
China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).


COTAS EM:
S/C

Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

ESCALA:
S/E

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

ANEXO:
04/08

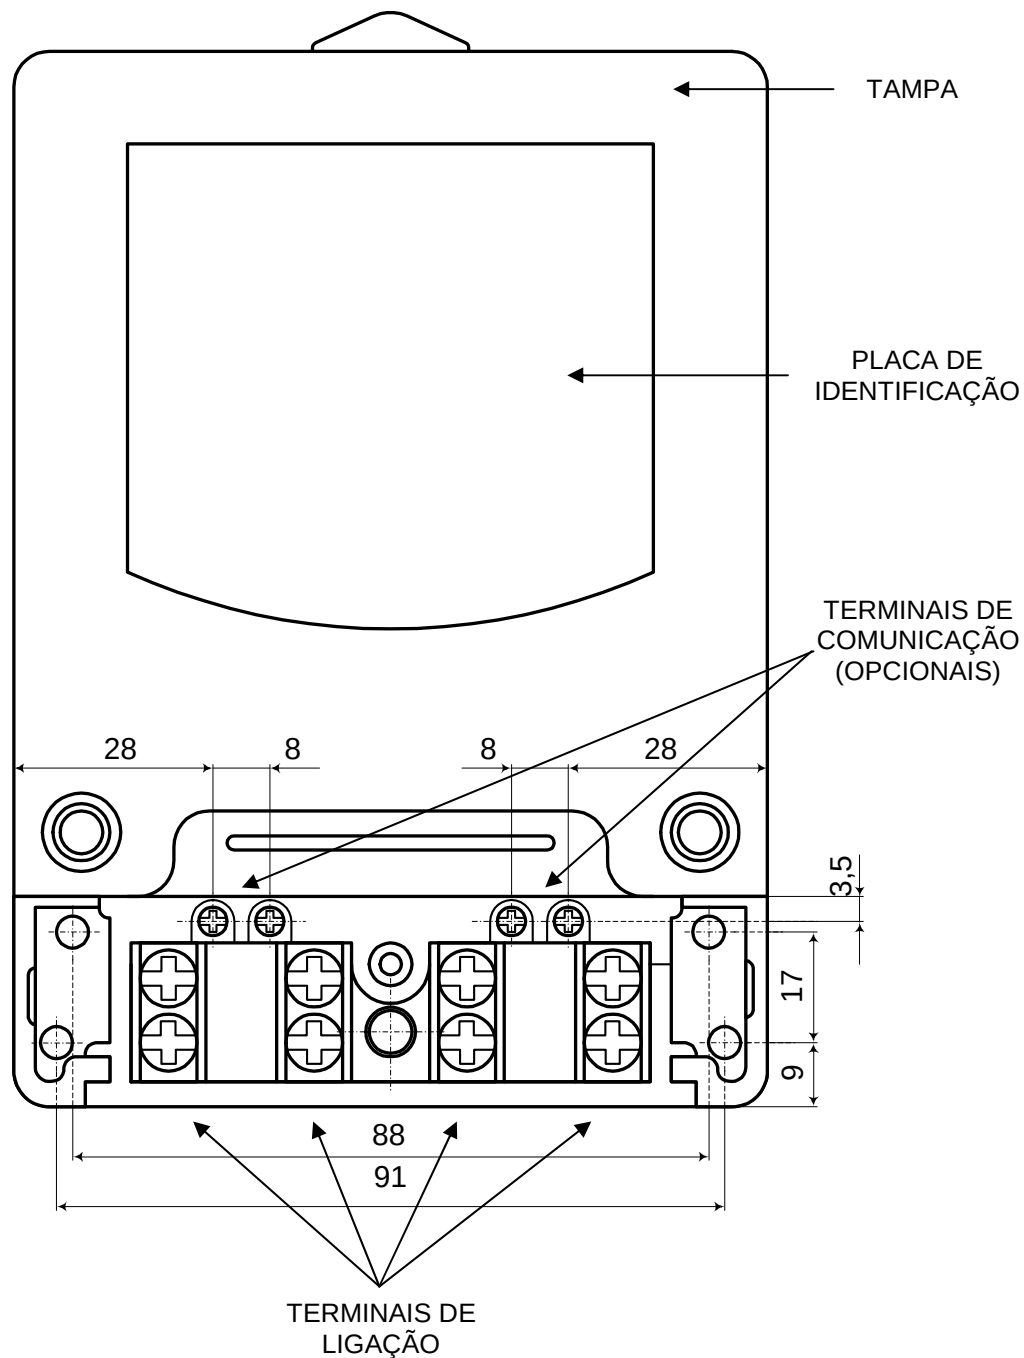

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).

COTAS EM:

S/C

Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2


ESCALA:

S/E

TERMINAIS DE LIGAÇÃO

ANEXO:

05/08

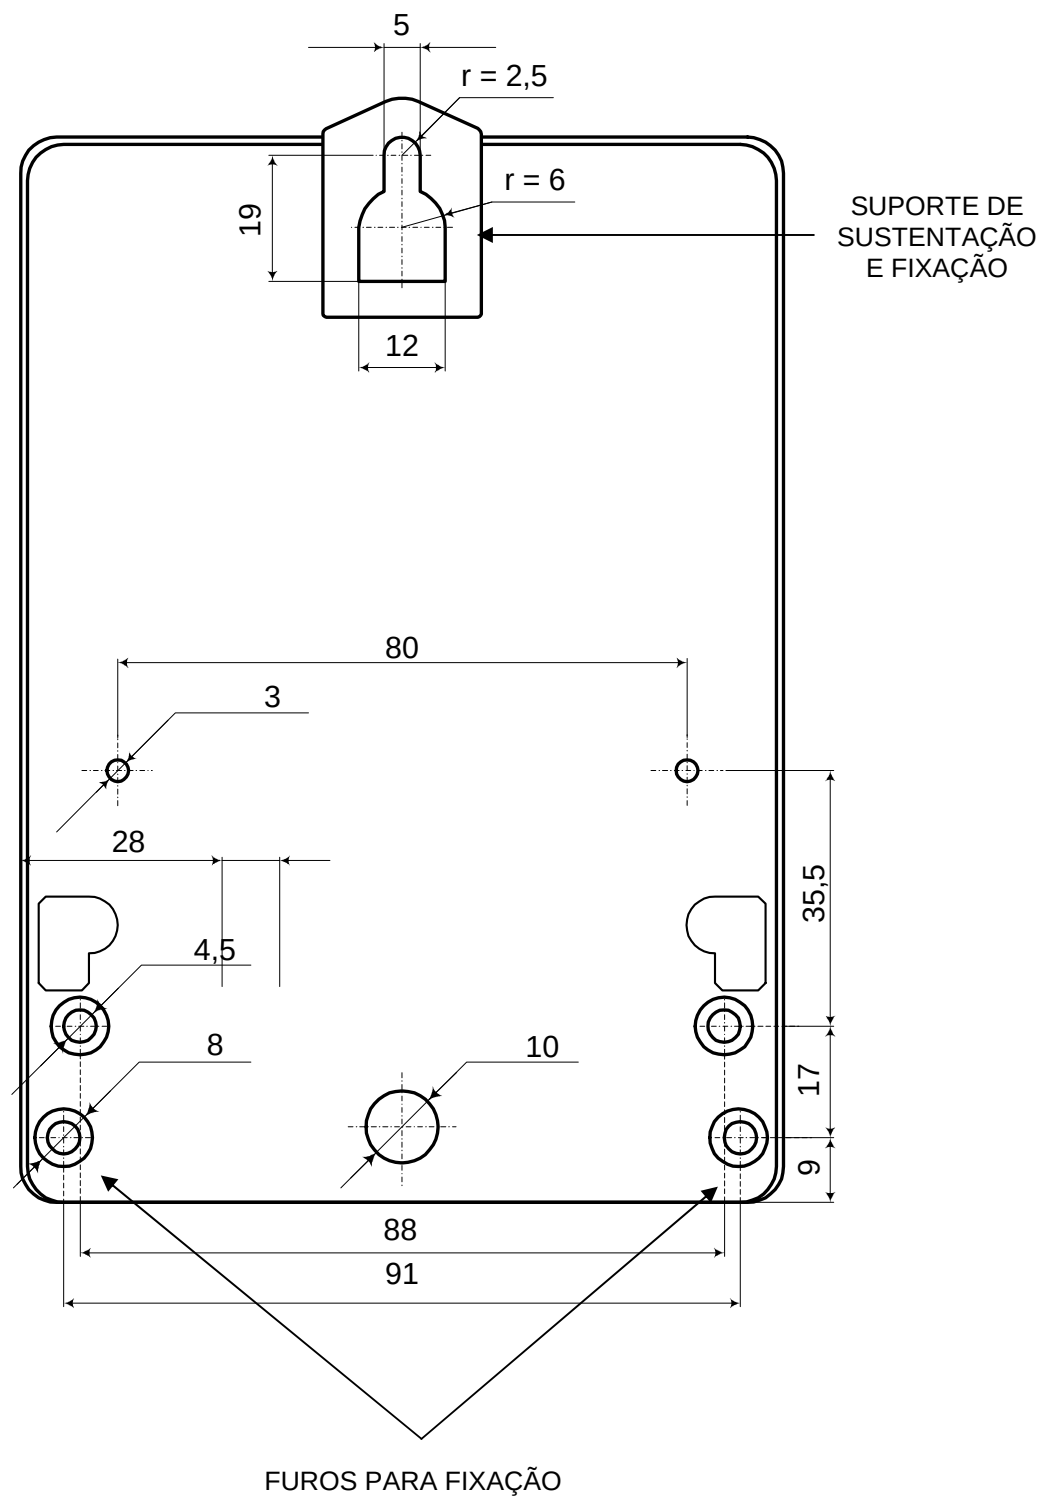

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).


Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

PONTOS DE FIXAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
06/08

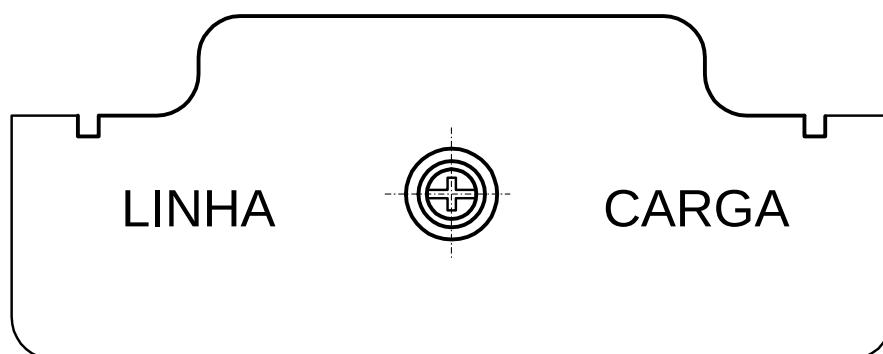

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).




Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
07/08

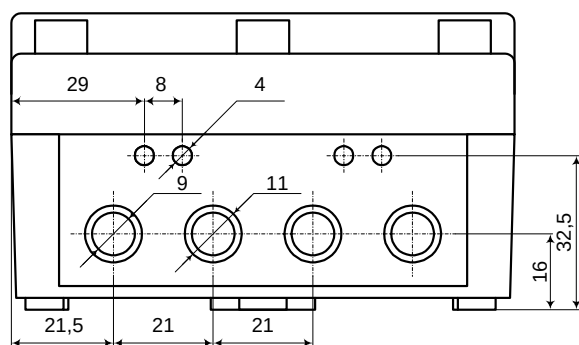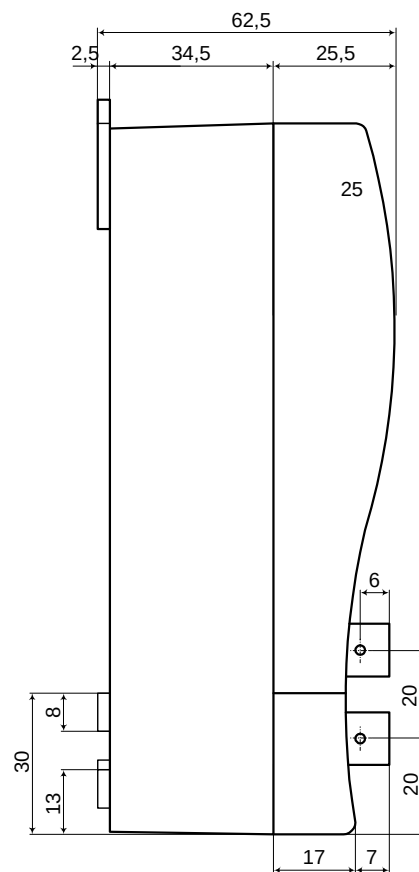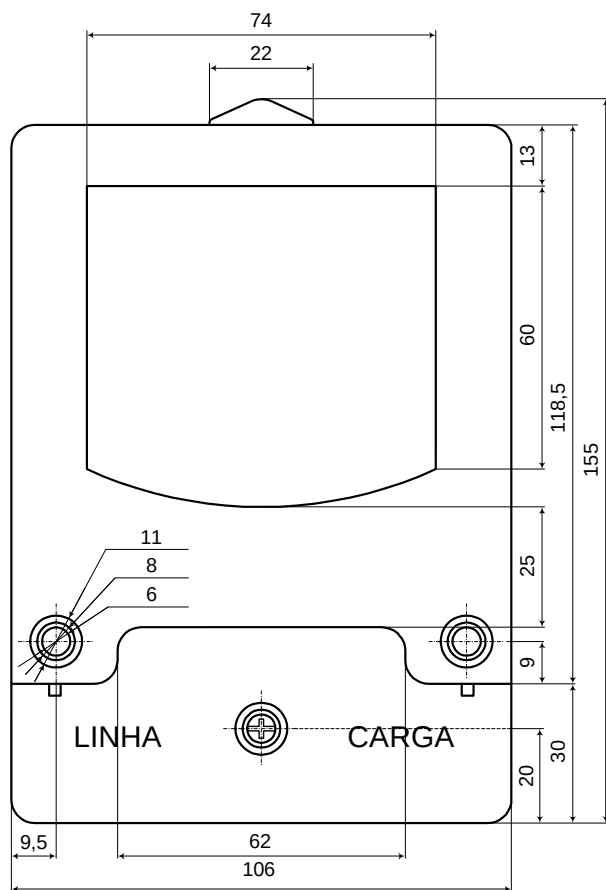

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0290, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.



FABRICANTE:

China National Complete Plant Imp. & Exp. Corporation (Group).

Modelos MEP01-PLC1 e MEP01-PLC2

DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
08/08