



Portaria Inmetro/Dimel nº 0202, de 31 de outubro de 2012.
(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 053/2012)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.029405/2012, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 053, de 23 de março de 2012, que aprova os modelos VECTOR PA e VECTOR PAR, de medidor eletrônico de energia elétrica, classe de exatidão B, marca NANSEN, resolve:

Art. 1º - Autorizar a utilização, em caráter opcional, nos modelos VECTOR PA e VECTOR PAR de led de indicação de ausência de carga, conforme indicado no desenho anexo à presente Portaria.

Art.2º - Substituir o ANEXO 02 no item 10 da Portaria Inmetro/Dimel nº 053, de 23 de março de 2012, pelo desenho introduzido à presente Portaria.

Art. 3º- Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Inmetro/Dimel nº 053, de 23 de março de 2012.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro





ANEXOS:

- ANEXO 02 – Placas de identificação

Dimel/Dgpro
Ppribeiro / Lcsantiliano
NANSEN_029405_12



Diretoria de Metrologia Legal - Dimel
Divisão de Gestão de Processos - Dgpro
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças nº 50- Xerém – Duque de Caxias- RJ - CEP: 25250-020
Telefones: (0xx21) 2679-9163 Fax: (0xx21) 2679-9163 - e-mail: dgpro@inmetro.gov.br

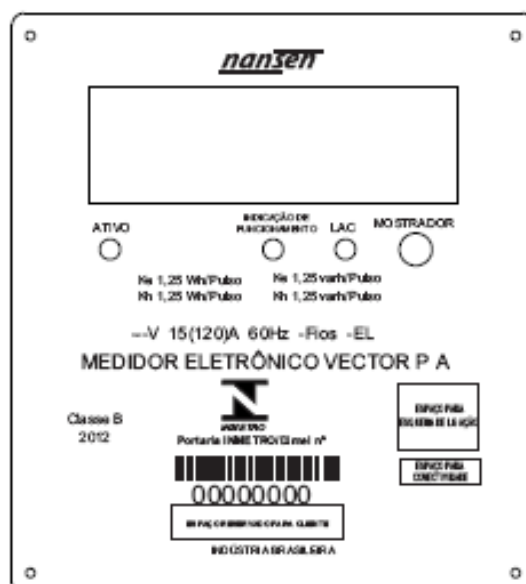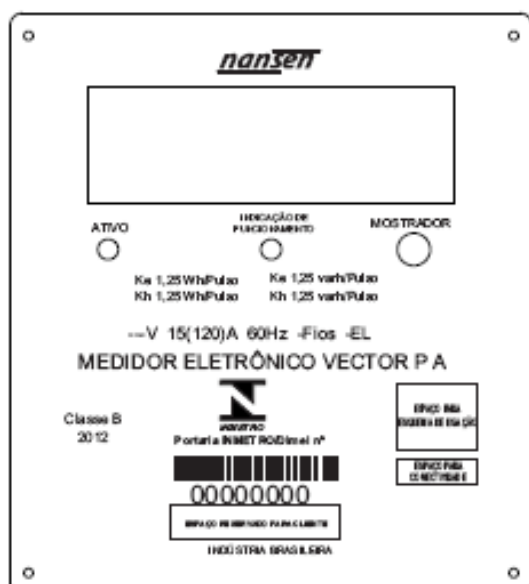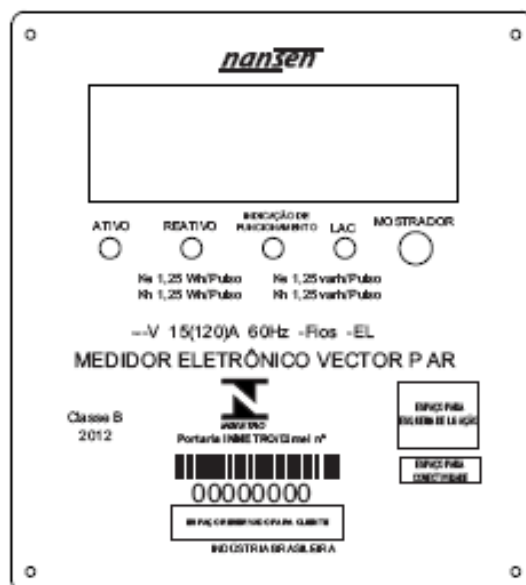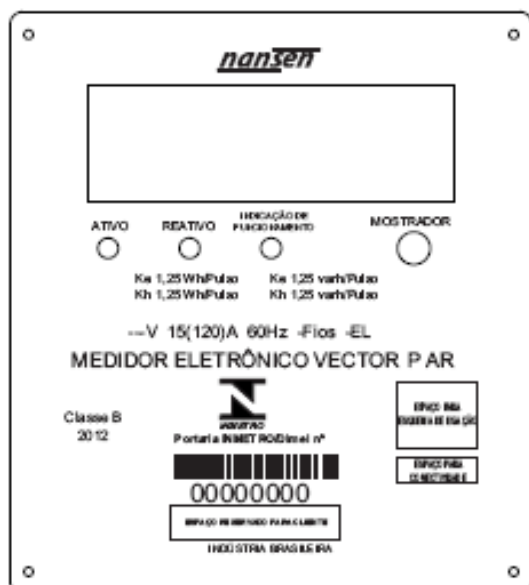

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS:

3EL	4Fios	3Fases
2EL	3Fios	2Fases


ESQUEMA DE LIGAÇÃO:



TENSÕES POSSÍVEIS:

120V
240V
120,240V

CONECTIVIDADES:



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0202, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

	FABRICANTE: NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO.	COTAS EM: S/C
	Modelos VECTOR PAR e VECTOR PA	ESCALA: S/E
	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	ANEXO: 02